E Lámpara UV Spot móvil

PRECAUCIÓN:

¡Obsérvense las instrucciones de servicio!

Tanto la instalación de accesorios como la ampliación del equipo incorporando componentes adicionales deberá efectuarse de acuerdo a las pautas facilitadas en las instrucciones de servicio.

La lámpara UV Spot móvil está disponible en dos variantes de equipamiento:

- Equipo estándar **Spot 30** compuesto de: cuerpo de luminaria [3], dos pies de apoyo desmontables [10] (además de 2 escuadras de sujeción para el modelo KS 9 a fin de ser utilizado como equipo colgante), protector de tubo fluorescente [4], cable de conexión con enchufe de aparato frío [8] y conector UV [9].
- Equipo colgante **Spot K** compuesto de: cuerpo de luminaria [14] y protector de tubo fluorescente [13] con cable de conexión para el conector UV [11]. Para utilizar el equipo colgante se necesita el kit de suspensión disponible como accesorio adicional. (KS 9 - nº ref.: 50073943 / KS 12 - KS 18 - nº ref.: 50073944)

Montaje y puesta en marcha

1. El protector de tubo fluorescente [4] está fijado con un tornillo de cabeza moleteada en cada extremo del cuerpo de luminaria [3]. Extraer los tornillos y quitar el protector de tubo fluorescente.
2. Instalación de los equipos:
   - En el equipo de pie (**Spot 30**), fijar los dos pies de apoyo [10] mediante los tornillos de cabeza moleteada en los extremos izquierdo y derecho del cuerpo de luminaria. Colocar el equipo de pie en el centro del espacio útil. Conectar el enchufe de aparato frío [8] a la caja de enchufe [7] situada en el cuerpo de luminaria. Conectar el conector UV a uno de los dos adaptadores UV internos.
     El modelo KS 9 ofrece la posibilidad de utilizar la lámpara UV en combinación con un kit de suspensión. Para ello, se deberán atornillar las escuadras de sujeción [6] en lugar de los pies de apoyo.
   - Fijar el equipo colgante (**Spot K**) a través de los dos ganchos [2] al kit de suspensión [1]. Conectar el conector UV [11] a uno de los dos adaptadores UV internos.

NOTA – ¡Radiación ultravioleta

Antes de conectar y activar la lámpara UV Spot móvil, deberán retirarse del espacio útil todos los medios auxiliares y muestras.

PRECAUCIÓN – ¡Peligro de quemaduras!

Durante el proceso de desinfección, la lámpara UV alcanza temperaturas muy elevadas. Antes de desmontar la lámpara UV Spot móvil, ¡esperar hasta que el cuerpo de luminaria se haya enfriado lo suficiente!

Spot 30

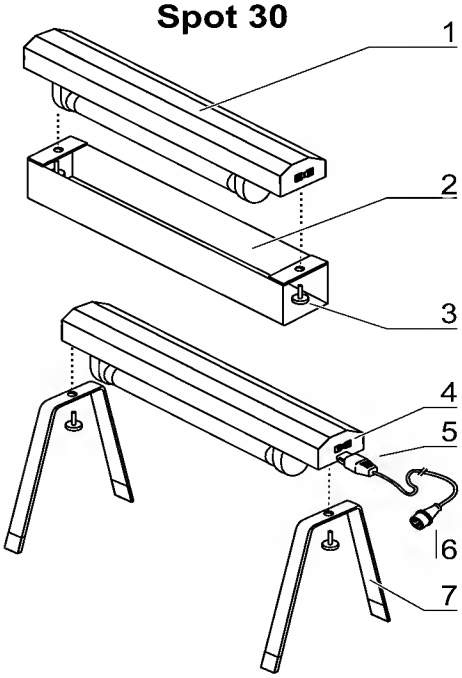

Spot K

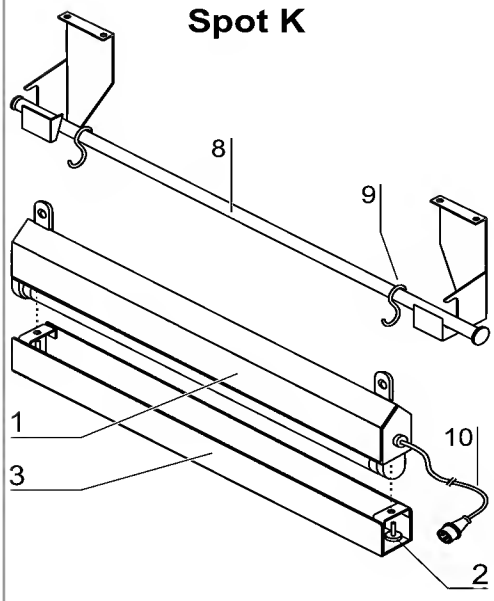

E Lámpara UV Spot móvil

3. Puesta fuera de servicio:
   Desconectar el cable de alimentación. En el caso del equipo de pie, desatornillar los pies de apoyo. Fijar el protector de tubo fluorescente al cuerpo de luminaria mediante los tornillos de cabeza moleteada.

Recambios

Descripción	Nºs de referencia para pedidos:			
	SPOT 30		SPOT K	
	120 V	230 V	120 V	230 V
Portalámparas (con acoplamiento de clavijas)	50043771	50043771	50043771	50043771
Cebador UV lateral 2 x 18 W 230 V		50048679		
Cebador UV lateral 2 x 15 W 120 V	50060299			
Cebador para lámpara UVC, 230 V				50048679
Cebador para lámpara UVC, 120 V			50060299	
Lámp. esteriliz. UVC 15 W lg 435 mm 230 V		50048537		50048537
Lámp. esteriliz. UVC 15 W lg 435 mm 120 V	50060298		50060298	
Cable con enchufe hembra	50048531	50048531	50048531	50048531
Pie de apoyo	50048676	50048676	50048676	50048676
Tornillo de cabeza moleteada	50049781	50049781	50049781	50049781
Instrucciones de servicio	50077503	50077503	50077503	50077503

Datos técnicos

Descripción	Unidad	SPOT 30		SPOT K	
Ancho	mm	80		60	
Alto	mm	115		170	
Alto con pie de apoyo	mm	310		365	
Largo	mm	520		995	
peso	kg	2		4,5	
Datos eléctricos					
Tensión asignada	Voltius	120	230	120	230
Frecuencia asignada	Hz	60	50	60	50
Wellenlänge	nm	254	254	245	245